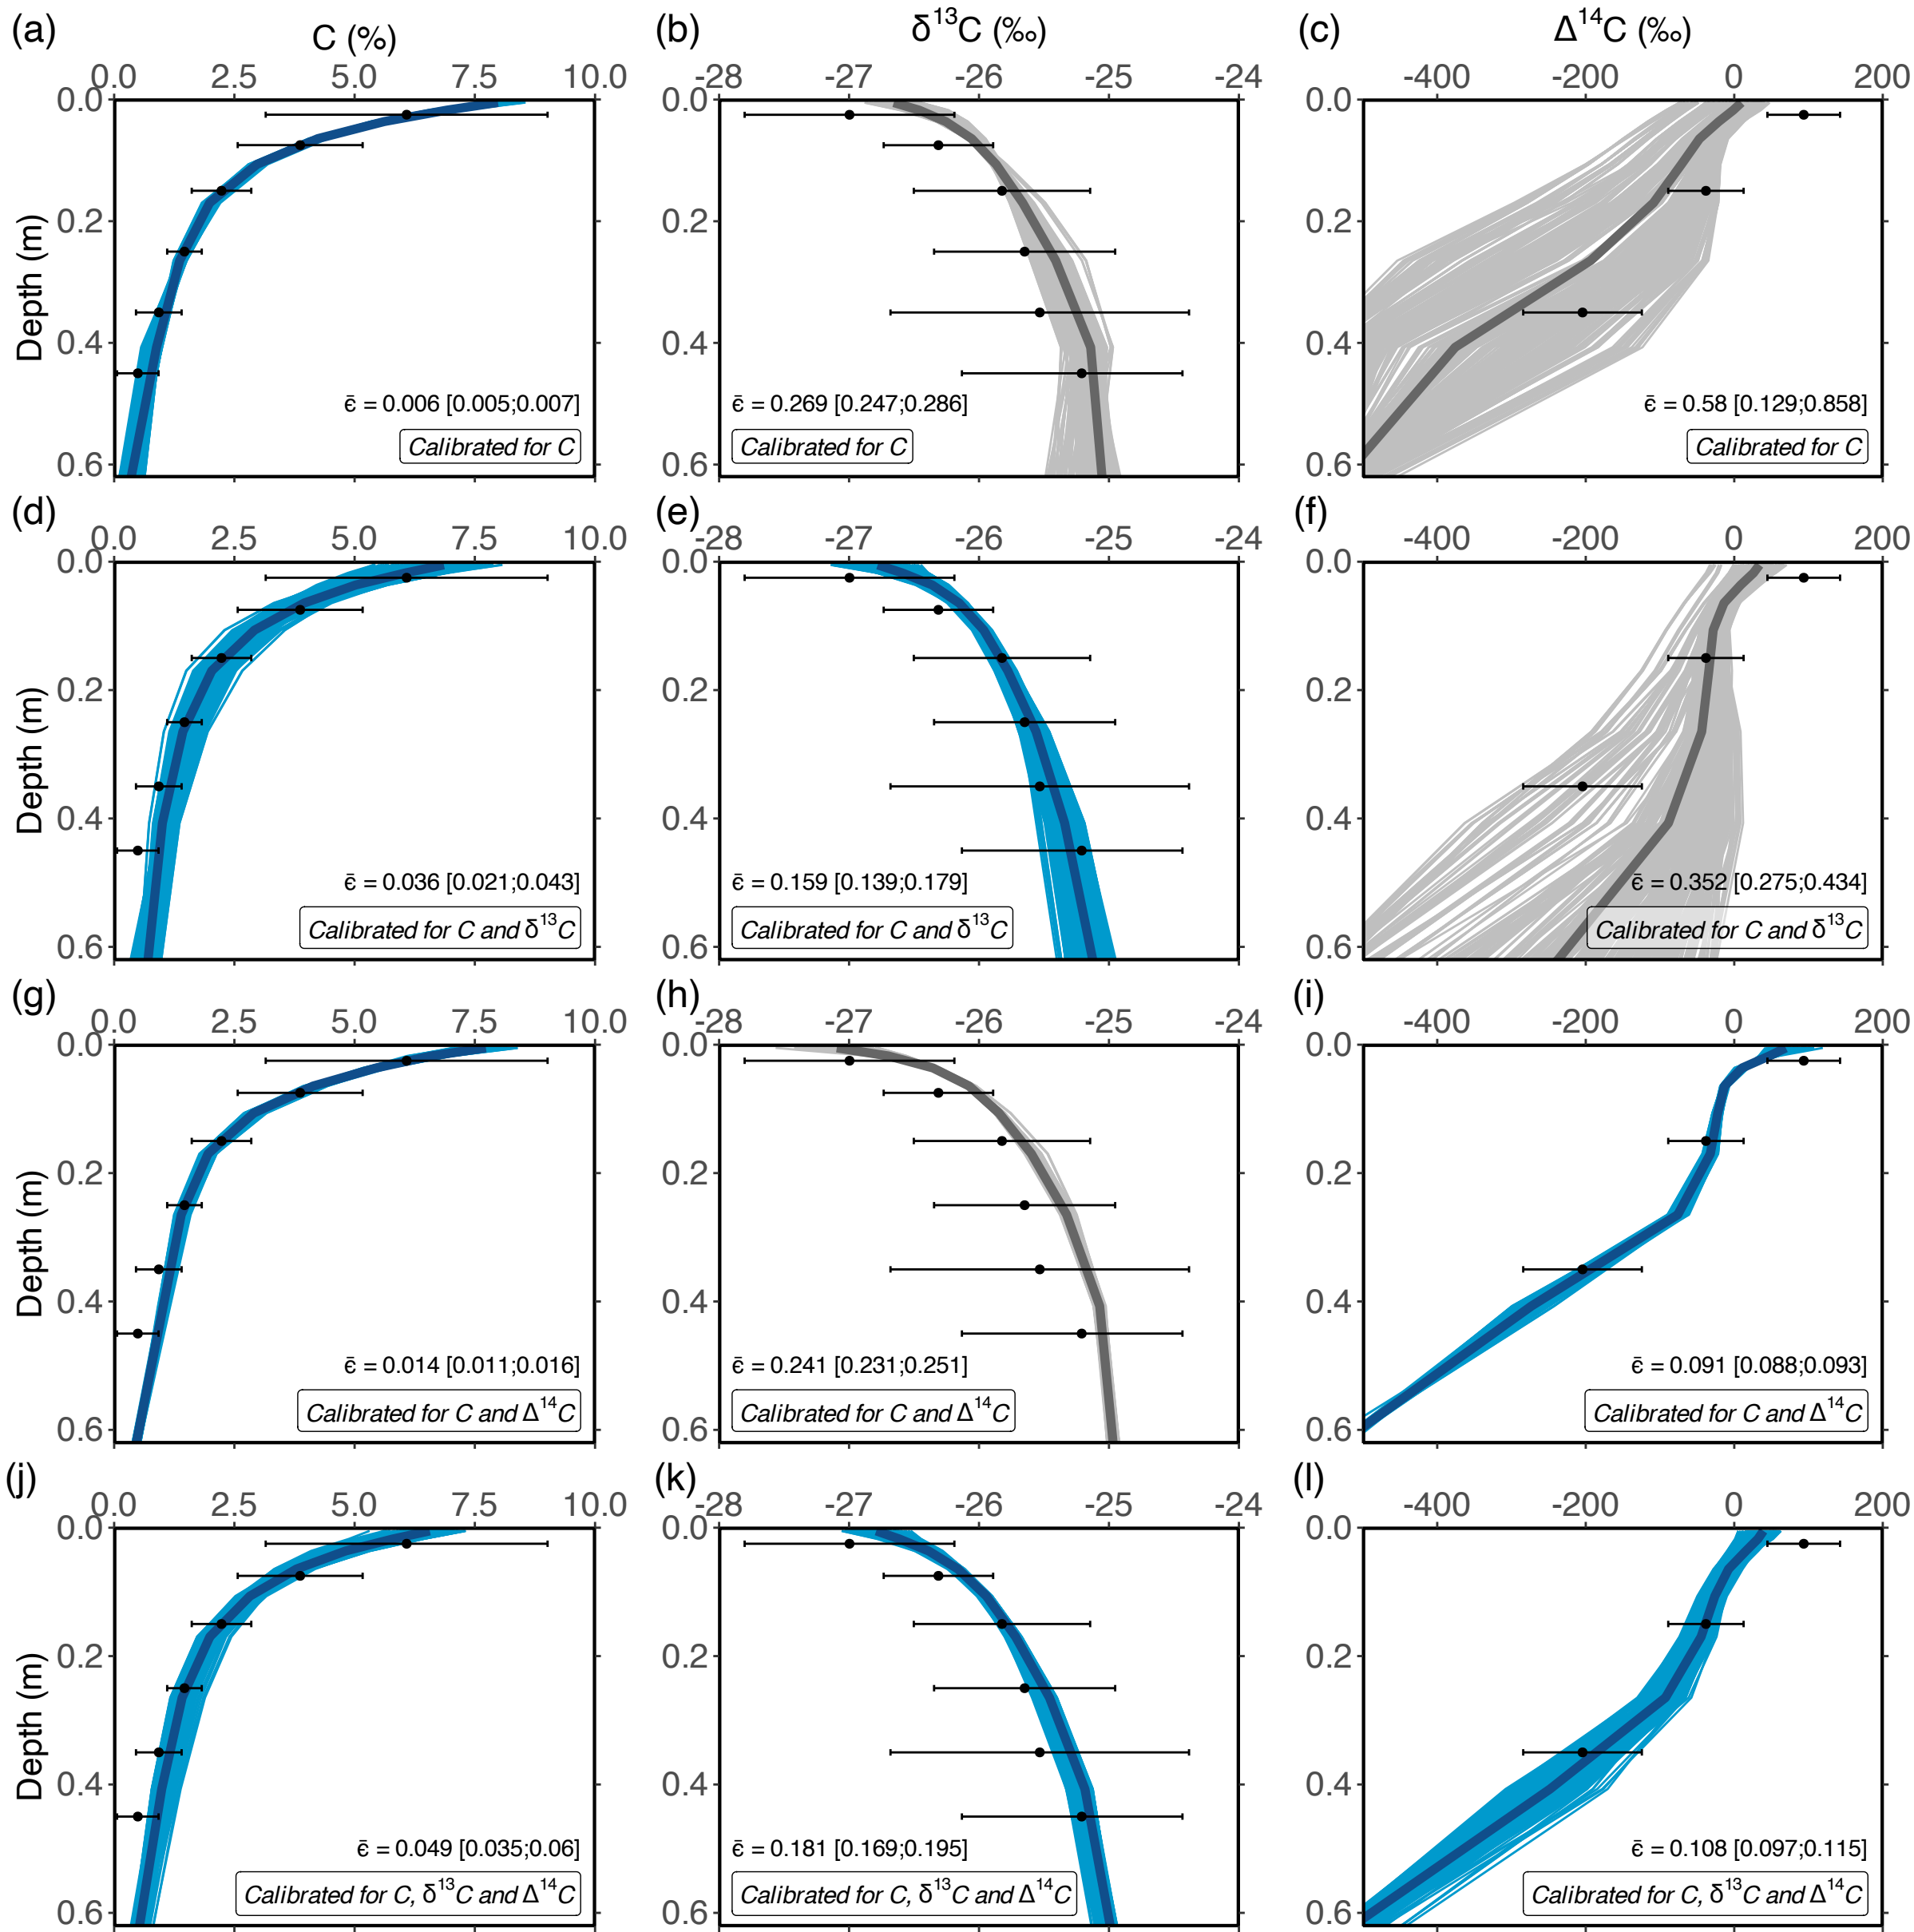
(a)
C (%)
Depth (m)
ϵ̄ = 0.006 [0.005;0.007]
Calibrated for C
(b)
δ13C (‰)
ϵ̄ = 0.269 [0.247;0.286]
Calibrated for C
(c)
Δ14C (‰)
ϵ̄ = 0.58 [0.129;0.858]
Calibrated for C
(d)
ϵ̄ = 0.036 [0.021;0.043]
Calibrated for C and δ13C
(e)
ϵ̄ = 0.159 [0.139;0.179]
Calibrated for C and δ13C
(f)
ϵ̄ = 0.352 [0.275;0.434]
Calibrated for C and δ13C
(g)
ϵ̄ = 0.014 [0.011;0.016]
Calibrated for C and Δ14C
(h)
ϵ̄ = 0.241 [0.231;0.251]
Calibrated for C and Δ14C
(i)
ϵ̄ = 0.091 [0.088;0.093]
Calibrated for C and Δ14C
(j)
ϵ̄ = 0.049 [0.035;0.06]
Calibrated for C, δ13C and Δ14C
(k)
ϵ̄ = 0.181 [0.169;0.195]
Calibrated for C, δ13C and Δ14C
(l)
ϵ̄ = 0.108 [0.097;0.115]
Calibrated for C, δ13C and Δ14C